


時刻: 09:23:51, 02/02/2015

UV

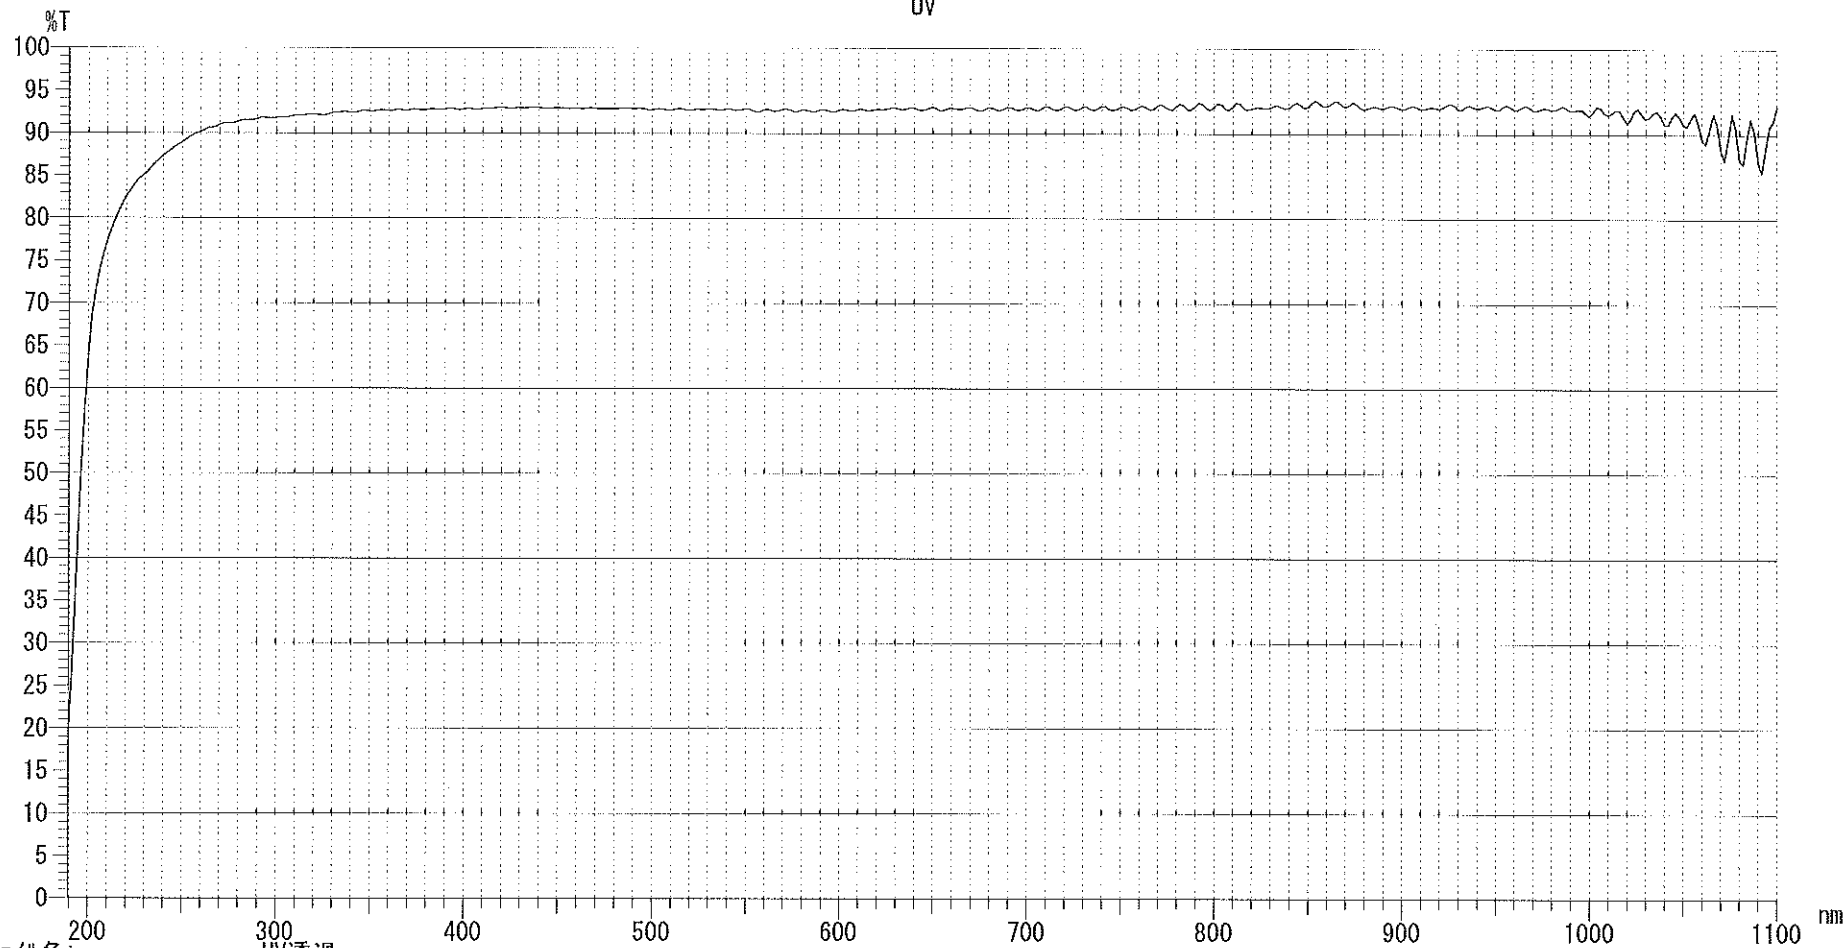

ファイル名: UV透過
コメント: t:1.23 (mm)
分析日時: 09:46:21, 06/22/2011
装置条件
測定モード: 波長スキャン
データモード: %T
開始波長: 1100.0 nm
終了波長: 190.0 nm
スキャンスピード: 400 nm/min

サンプル間隔: 2.0 nm
初期待ち時間: 0 s
繰り返し周期: 0.0 min
測定回数: 1
測定前オートゼロ: Off

スリット: 5.00 nm
ベースライン設定: ユーザー
レスポンス: 標準
セル長: 10.0 mm
データ間隔: 標準